



Nominativo Cliente: Comune di Monastir

Contratto di noleggio, installazione e manutenzione di Nr.1 dispositivo per il controllo elettronico della velocità da postazione fissa non presidiata e da relativo software (Rep. 232 del 12/02/2009)

**VERBALE DI INSTALLAZIONE E VERIFICA DELLA CORRETTA
FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO**

L'anno 2010 addì 28 del mese di APRILE, presso il seguente sistema di controllo

☐ del passaggio col rosso

☒ del superamento del limite di velocità

Anagrafica Impianto

Nome Impianto	MON-SS131-DIR-CAGLIARI
Identificativo Impianto	0000001
Numero di serie Impianto	MON-N1076-01-CV
Matricola TraffiStar SR 520	593-071/60432

sito in c/o SS 131 al Km 19+392 in direzione Cagliari, in accordo col decreto di **Omologazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. 47177 del 04/06/2008 alla Lindblad & Piana srl**, i sottoscritti:

- Sig. A. PILLONI in qualità di Operatore della ditta Project Automation SpA di Monza (MI)
- L. PERRA e
in qualità di Rappresentante dell'Organo accertatore

Prendono atto di quanto segue:

1. A. PILLONI dichiara di aver ultimato l'installazione e attivazione del suddetto impianto
2. A. PILLONI unitamente a L. PERRA procedono alla verifica della corretta funzionalità dell'impianto, in accordo con quanto riportato nel Manuale per l'Utente consegnato all'Organo accertatore (come prescritto dal Decreto di Omologazione).



Si attesta inoltre che le prove di verifica funzionale hanno evidenziato la perfetta efficienza dell'impianto e si procede pertanto alla chiusura della presente verbalizzazione di cui è parte integrante la seguente documentazione:

- **Certificato di verifica periodica impianto - Taratura SIT Traffiphot III SR-Photor&V Nr. 5451/2010**
- **Scheda di Configurazione impianto**

Si attesta inoltre che le prove di verifica funzionale hanno evidenziato la perfetta efficienza dell'impianto e si procede pertanto alla chiusura della presente verbalizzazione di cui è parte integrante la seguente documentazione:


- **Certificato di verifica periodica impianto - Taratura Traffiphot III SR-Photor&V**
- **Scheda di Configurazione impianto**

Letto, confermato e sottoscritto

MODASTR, li 28/4/2010.

Per Project Automation SpA

L'Operatore




Il Responsabile





Per l'Organo accertatore

Il Comandante della Polizia locale

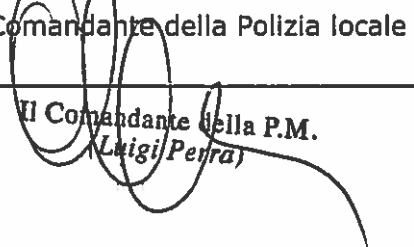
Il Comandante della P.M.
(Luigi Perri)

Allegati: c.s.d.

CENTRO DI TARATURA 101
Calibration Centre 101



Tarature e Servizi alle Imprese

T.E.S.I S.r.l.

Sede: Zona Industriale Castelnuovo, 242/B, 52010 Subbiano (AR)

Tel +39 0575 422468, fax +39 0575 421282

Pagina 1 di 3
Page 1 of 3

CERTIFICATO DI TARATURA N. 5451_2010_SIT
Certificate of Calibration No. 5451_2010_SIT

- Data di emissione
date of issue
- destinatario
addressee
- richiesta
application
- in data
date

2010-06-03

Project Automation S.p.A.
Viale Elvezia, 42 Monza (Mi)
CPJ

2010-02-15

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento SIT N. 101 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). Il SIT garantisce le capacità di misura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

Si riferisce a
referring to

- oggetto
item
- costruttore
manufacturer
- modello
model
- matricola
serial number
- data delle misure
date of measurements
- registro di laboratorio
laboratory reference

Misuratore di Velocità di Autoveicoli

RobotVisualSystemsGmbH
divisione TRAFFIPAX
TraffiStar SR 520

MON-N1076-01-CV (impianto) + 593-
206/62095 (box) + 593-071/60432 (misuratore)
2010-04-28

RLT/SIT_2010

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation SIT No. 101 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. SIT attests the measurement capability and metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
Ing.  Marco Forpora

CENTRO DI TARATURA 101

Calibration Centre 101



Tarature e Servizi alle Imprese

T.E.S.I.S.r.l.

Certificato di taratura n. 5451_2010_SIT

Certificate of calibration No. 5451_2010_SIT

Pagina 2 di 3

Page 2 of 3

Di seguito, vengono riportate le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'oggetto in taratura (se necessaria);
- l'identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature;
- i campioni di prima linea da cui ha inizio la catena della riferibilità del Centro;
- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e l'Ente che li ha emessi;
- luogo di taratura (se effettuata fuori dal Laboratorio);
- condizioni ambientali e di taratura;
- i risultati delle tarature e la loro incertezza estesa.

In the following, information is reported about:

- description of the item to be calibrated (if necessary);*
- technical procedures used for calibration performed;*
- reference standards from which traceability chain is originated in the Centre;*
- the relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body;*
- site of calibration (if different from the Laboratory);*
- calibration and environmental conditions;*
- calibration results and their expanded uncertainty.*

1-MODALITA' E CONDIZIONI DI MISURA

L'oggetto in taratura è un misuratore di velocità di autoveicoli di tipo a installazione fissa, basato su spire magnetiche.

La taratura è stata effettuata nel sito d'installazione transitando con diverse autovetture nello spazio di rilevazione dello strumento e misurando simultaneamente la velocità con il sistema di misura del Centro. I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura P_AUTOV1 revisione 9.

La postazione fissa di misura è situata a

Monastir (CA) SS131 km 19+392 direzione Cagliari

La catena di riferibilità ha origine dai campioni di prima linea:

PRIM_TF1 matricola N. 06179 munito di Certificato di Taratura S.I.T. N. 10-0231-01 emesso dall'Istituto Nazionale Ricerca Metrologica "I.N.Ri.M".

PRIM_LUN6 matricola N. TES0580 munito di Certificato di Taratura S.I.T. N. 10-396-002 emesso dal Centro SIT 110 TEC EUROLAB

La taratura è stata eseguita nelle seguenti condizioni:

– temperatura ambiente nel campo (28+/-3)°C ed umidità relativa (38+/-5)%

Sullo strumento in taratura sono state eseguite le seguenti operazioni:

- verifica iniziale

La distanza tra le spire 1-2 e 3-4 impostata sull'apparecchiatura in taratura (LOOP DISTANCE) è 2,500.

Nelle tabelle seguenti viene riportata la stima dello scarto nel campo di velocità da 30 a 100km/h espresso in termini assoluti, e oltre 100km/h espresso in termini relativi percentuali, insieme alle incertezze di taratura, valutate come due volte lo scarto tipo (corrispondente ad un livello di fiducia di circa 95%).

Viene inoltre riportato il valore massimo dell'errore calcolato assumendo un livello di fiducia superiore al 99,7%

CENTRO DI TARATURA 101

Calibration Centre 101

**T.E.S.I S.r.l.**Certificato di taratura n. 5451_2010_SIT
Certificate of calibration No. 5451_2010_SITPagina 3 di 3
Page 3 of 3**2-RISULTATI ED INCERTEZZE DI MISURA****2.1 Campo di velocità da 30 a 100km/h****2.1.1 Allontanamento**

Stima dello scarto della velocità misurata dall'UUT rispetto al riferimento ($v_{UUT}-v_{ref}$):	-0,36 km/h
Incertezza estesa associata alla stima degli scarti:	0,36 km/h
Scarto di velocità massimo positivo calcolato:	+1,43 km/h
Numero di misure effettuate:	44

2.2 Campo di velocità oltre 100km/h**2.2.1 Allontanamento**

Stima dello scarto della velocità misurata dall'UUT rispetto al riferimento ($v_{UUT}-v_{ref}$):	0,42 %
Incertezza estesa associata alla stima degli scarti:	0,51 %
Scarto di velocità massimo positivo calcolato:	+1,52 %
Numero di misure effettuate:	20

Lo scarto di velocità massimo è stato ottenuto sommando allo scarto medio la deviazione standard degli scarti moltiplicata per un fattore di copertura che, in base al numero di misure effettuate corrisponde ad un livello di fiducia superiore al 99,7%.

ALLEGATO AL CERTIFICATO DI TARATURA N. 5451_2010_SIT
ATTACHMENT TO THE TEST CERTIFICATE N. 5451_2010_SIT

- Data di emissione 2010-06-03
- *date of issue*
- destinatario Project Automation S.p.A.
- *addressee*

Si riferisce a

referring to
- oggetto Misuratore di Velocità di Autoveicoli
- *item*
- costruttore RobotVisualSystemsGmbH
- *manufacturer* divisione TRAFFIPAX
- modello TrafficStar SR 520
- *model*
- matricola MON-N1076-01-CV (impianto) + 593-206/62095 (box) + 593-071/60432 (misuratore)
- *serial number*
- data delle misure 2010-04-28
- *date of measurements*

Il certificato n. 5451_2010_SIT riporta i risultati delle misure e le incertezze ad esse associate rilevate in fase di verifica iniziale, cioè nello stato in cui era lo strumento al momento della taratura.

Gli errori positivi massimi calcolati rientrano nei limiti del 5% con minimo di 5km/h
Non è stata effettuata alcuna operazione di messa in punto (regolazione)

Il Centro di taratura di T.E.S.I., essendo accreditato SIT per le misure oggetto di detto certificato, opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 "Requisiti Generali per la Competenza dei Laboratori di Prova e Taratura" che definisce i requisiti di Assicurazione Qualità dei Laboratori di Taratura

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

T.E.S.I. s.r.l.

Sede sociale ed operativa: Zona Industriale Castelnuovo, 242/B-52010 Subbiano (AR)- Tel 0575 422468 - Fax 0575 421282

Sede operativa nord Italia: Viale Lombardia, 29 - 20047 Brugherio (MI)- Tel 039 2879091 - Tel e Fax 039 2873824

info@tesi-sit101.com - www.tesi-sit101.com